

IN-002: 麻酔用N2Oガス回収・分解システムの導入

【削減方法】

- 麻酔用一酸化二窒素(N2O)ガスが使用される医療施設において、麻酔用N2Oガス回収・分解システムを導入することでプロジェクト実施前に無処理で大気放出させていたN2Oガスを回収・分解する。

【適用条件】

- ① 新たに麻酔用N2Oガス回収・分解システムを導入すること。

【ベースライン 排出量の考え方】


- プロジェクト実施後のN2Oガスを、麻酔ガスの回収・分解装置の導入を行わずに、大気放出し続ける場合に想定されるN2O排出量。

【主なモニタリング項目】

- プロジェクト実施後におけるN2Oガス使用量
- プロジェクト実施後のN2Oガス回収・分解装置における電力使用量

【方法論のイメージ】

ベースライン

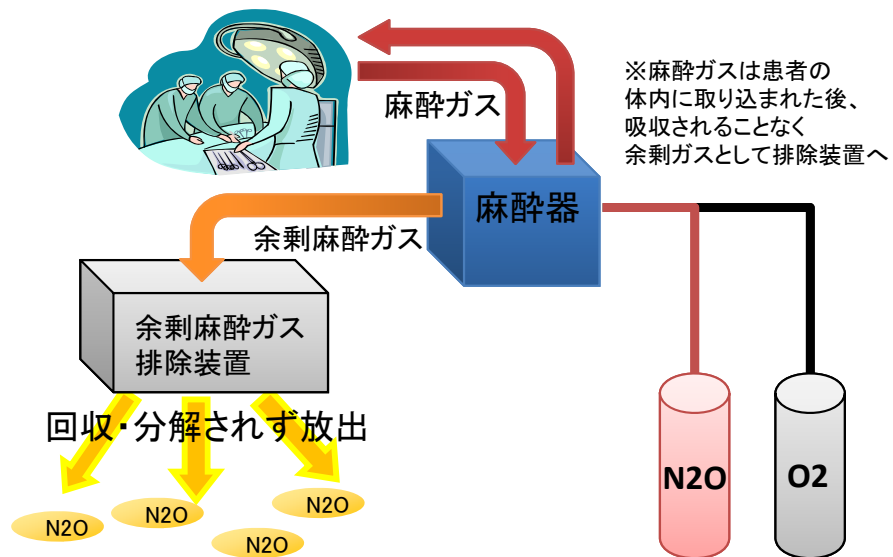

プロジェクト実施後

